

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

dot. zapytania ofertowego nr DA/DT-381-16/24 z dnia 02.04.2024 r. na przegląd pomp próżniowych DVP LC 305 dla Narodowego Instytutu Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

W związku z złożonymi zapytaniami odnośnie w/w postępowania Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytania 1: Proszę o podanie numeru seryjnego filtra bakteriobójczego, filtra powietrza.

Odpowiedź 1: Nie posiadamy numerów seryjnych filtrów.

Wymiary filtrów bakteriobójczych:

średnica otworu wewnętrznego: 106 mm,

średnica otworu zewnętrznego: 170 mm,

długość filtra: 180 mm.

Wymiary filtrów powietrza:

średnica otworu wewnętrznego: 88 mm,

średnica otworu zewnętrznego: 150 mm,

długość filtra: 213 mm.


Pytania 2: Proszę także o informację na temat:

- z jakiej średnicy są zawory zwrotne

- jaki jest stosowany olej do pomp

Odpowiedź 2: Po sprawdzeniu Dokumentacji Technicznej nie posiadamy wykazu poszczególnych części oraz elementów wchodzących w skład pomp próżniowych. Tabliczki znamionowe znajdują się w załączniku nr 3.

Poniżej zdjęcie oleju obecnie zastosowanego w pompach próżniowych:

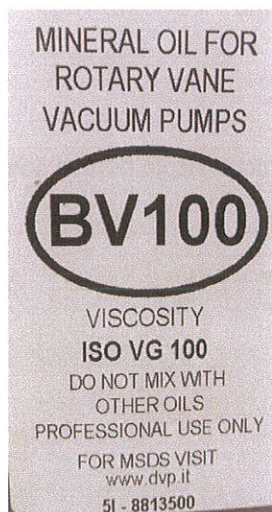

**Zmiana terminu składania ofert: 11.04.2024 r.**

wz. kierownika DODD  
M. Wodulskiego - Omislu

KIEROWNIK  
Wydziału Nadzoru i Usług Technicznych  
KIEROWNIK  
Sekcji Gazów i Sprężyn  
inż. *Wąsik*  
Paweł Ficek

**Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie –  
Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  
44-102 Gliwice

**Dyrekcja**  
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl  
www.gliwice.nio.gov.pl

**Centrala**  
Tel.: +48 32 278 88 88  
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028