

Gliwice, dnia 16 marca 2021 r.

DO / DZ – TPbn – 381 – 2 – 9 /21

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH**

dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00015115/01, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi pytaniami odnośnie ww. postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) przekazuje Państwu treść otrzymanych zapytań jak i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy, w której diody zabezpieczone są osłonami wykonanymi z poliwęglanu, który jest bardziej odporny na zarysowania niż szkło? – dotyczy l.p. 3

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy jednoczasowej jak na załączonej wizualizacji? Czasza okrągła, z dwoma zintegrowanymi z lampą uchwytyami brudnymi ułatwiającymi pozycjonowanie lampy, z możliwością wsunięcia całej dłoni. Uchwyt sterylny umieszczony centralnie – dotyczy l.p. 4, 13

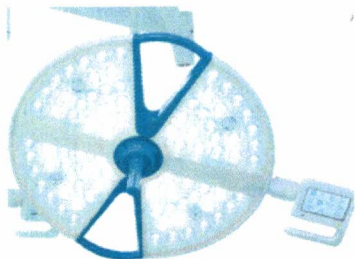

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy czaszy 600mm? Wielkość czaszy nie ma wpływu na jej walory kliniczne. – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w 88 diod led? Ilość diod nie ma wpływu na walory kliniczne lampy. – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola regulowanej w zakresie 22-34cm? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku R9=93? – dotyczy l.p. 14

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku Ra=97? – dotyczy l.p. 15

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o długości ramienia do oprawy świetlnej 933mm? – dotyczy l.p. 18

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o mocy 110W? – dotyczy l.p. 19

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy: Załącznika nr 2.1 do SWZ

Część 1, lampy zabiegowe (3szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o długości podstawy 850mm? – dotyczy l.p. 24

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Zadania nr 2 - Dopuszczenie laparoskopu

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Zamawiający mając na uwadze dyspozycję art. 284 ust. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 18.03.2021 r. na dzień 19.03.2021 r. - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą z dnia 16.04.2021 r. na dzień 17.04.2021 r.

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotuła

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Aparatury Medycznej
inż. Weronika Smolarz

Maliu